

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
M O S T A R**

**Broj: 4312/2/19
Mostar, 01.07.2019.**

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH («Službeni glasnik BiH» 39/14), članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu, evid.br: 4312/19 od dana 24.06.2019. godine ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

**ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja**

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave **višeslojnog ultrabrzog uređaja za računalnu tomografiju (MSCT), za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar** utvrđuje se tvrtka **"MEDICAL" d.o.o.**, Maršala Tita 237, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

II

Sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH” broj 39/14), ovu Odluku objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Odluku dostaviti ponuditeljima.

O b r a z l o ž e n j e

U otvorenom postupku javne nabave višeslojnog ultrabrzog uređaja za računalnu tomografiju (MSCT), za potrebe Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, objavljene na Portalu javnih nabava, broj: 329-1-1-83-3-46/19 od 17.04.2019. godine, svoje ponude dostavili su ponuditelji **"SHIMADZU" d.o.o.**, Tešanjaska 7, 71 000 Sarajevo i **"MEDICAL" d.o.o.**, Maršala Tita 237, 88 000 Mostar.

Povjerenstvo za nabavu, imenovano Rješenjem Ravnatelja broj: 2662/2/19 je dana 03.06.2019. godine u 09:30 izvršilo javno otvaranje ponuda te konstatiralo sljedeće:

- Ukupan broj pristiglih ponuda je 2 (dva)
- Ukupan broj pravovremeno pristiglih ponuda je 2 (dva)
- Nema nepravovremeno pristiglih ponuda.

Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 2662/19, utvrđeno je sljedeće:

- Tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda nije primijenjen institut pojašnjenja.
- Nije bilo ispravaka u ponudama.
- Nisu tražene garancije za ozbiljnost ponude.
- Ponuda ponuditelja **"MEDICAL" d.o.o.** Mostar **ispunjava** zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija.
- Ponuda ponuditelja **"SHIMADZU" d.o.o.** Sarajevo **ne ispunjava** zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija iz sljedećih razloga:

Tražene tehničke karakteristike	Ponudeno:
1. CJELINA 1. KUĆIŠTE Točka 1.1. Otvor kućišta minimalno 78cm Točka 1.2. Najkraće vrijeme rotacije 0.28s	Navedenu specifikaciju NE zadovoljava ponuđeni uređaj za kompjuteriziranu tomografiju Fujifilm Speedia HD. Ponuđeni uređaj ima 75 cm otvor kućišta Navedenu specifikaciju NE zadovoljava ponuđeni uređaj za kompjuteriziranu tomografiju Fujifilm Speedia HD. Ponuđeni uređaj ima najkraće vrijeme rotacije 0.75 s
CJELINA 2. DETEKTOR Točka 2.5. Broj istovremeno očitanih detektorskih elemenata minimalno 100 000.	Ponuđeni uređaj ima broj istovremeno očitanih detektorskih elemenata 56 832.
CJELINA 3. RENDGENSKA CIJEV I GENERATOR Točka 3.1. Minimalna snaga generator 100kW Točka 3.3. Najniži promjenjivi napon cijevi maksimalno 70kV Točka 3.6. Maksimalna jakost struje rendgenske cijevi minimalno 740 mA.	Ponuđeni uređaj ima snagu detektora 51kW. Ponuđeni uređaj ima najniži promjenjivi napon cijevi od 80kV. Ponuđeni uređaj ima maksimalnu jakost struje od 400 mA
CJELINA 4. STOL ZA PACIJENTE Točka 4.2. Oslikavanje bez metalnih dijelova u najvećoj duljini minimalno 185 cm	Ponuđeni uređaj ima oslikavanje bez metalnih dijelova u najvećoj duljini 180 cm
CJELINA 7. METODE OSLIKAVANJA Točka 7.1. Pregled čitavih pluća (40cm) u najkraćem vremenu kraćem od 1.5 sekundu Točka 7.2. Izrazito brzo spiralno skeniranje od minimalno 400mm/sek uz polje pregleda od minimalno (FOV) 47cm bez smanjivanja kvalitete slike za preglede prsnog koša kod pregleda nemirnih pacijenata.	Ponuđeni uređaj treba najkraće vrijeme od 4.5 s za pregled čitavih pluća Ponuđeni uređaj ima mogućnost spiralnog skeniranja od 500 mm/sek uz polje pregleda od minimalno 47 cm bez smanjivanja kvalitete slike za preglede prsnog koša kod pregleda nemirnih pacijenata.

- Ponuda ponuditelja "SHIMADZU" d.o.o., Tešanjaska 7, 71 000 Sarajevo **se odbija kao neprihvatljiva** budući da ista ne ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmetne nabave i tehničkih specifikacija.
- Ponuditelj "MEDICAL" d.o.o. je dostavio sve dokumente sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije
 - Izjavu o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točka a) do d) Zakona (uključujući i dokaze o osobnoj sposobnosti čime se oslobađa naknadnog dostavljanja istih)
 - Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 46. stavak (1) Zakona
 - Ovjerena preslika aktualnog izvoda iz sudskog registra
 - Ovjerena preslika ID broja
 - Ovjerena preslika uvjerenja o PDV registraciji
 - Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 49. Zakona:
 - Autorizaciju proizvođača sa jasno navedenim nazivom predmetnog postupka i brojem nabave koji je odredilo Ugovorno tijelo: Odluka broj 2662/19
 - Izjavu da će rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o registraciji medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava dostaviti do trenutka isporuke predmetne robe
 - Rješenje o upisu u Registar veleprometnika medicinskih sredstava izdano od nadležnog tijela
 - Katalog predmetne opreme,
- Ponuda ponuditelja "MEDICAL" d.o.o., je ocijenjena kao **prihvatljiva**.

- Ponuda je vrednovana sukladno kriteriju za izbor ponude

Ev.br.	PONUĐITELJ	Potkriteriji koji se vrednuju unutar kriterija "ekonomski najpovoljnija ponuda"	Ukupno bodova
157/19	"MEDICAL" d.o.o. Maršala Tita 237 88 000 Mostar	- Ukupna cijena sa PDV-om: 2.866,500,00 KM / 60 bodova - Izlazak na servis (u satima): 3 (tri) sata/ 5 bodova - Brzina oslikavanja kod spiralnog skeniranja vidnog polja min 47 cm bez reduciranja kvaliteta slike (u milimetrima): 437,5 mm/s / 10 bodova - Vrijeme proteklo između oslikavanja sa različitim energijama (u milisekundama): 0,25 ms/ 5 bodova - Brzina oslikavanja cijelih pluća (u sekundama): 0,9 s/ 10 bodova - Efektivna temporalna rezolucija (u milisekundama): 29 ms/ 10 bodova	100


Sukladno kriteriju za dodjelu ugovora, ponuditelj "MEDICAL" d.o.o., Mostar dostavio je, u predmetnom postupku javne nabave, ekonomski najpovoljniju ponudu.

Temeljem gore navedenog Ravnatelj SKB Mostar donosi odluku kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba u roku do 10 (deset) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela.

Dostaviti:

1. Ponuditeljima
2. Povjerenstvu za nabavu
3. Službi za gospodarsko financijske poslove
4. Centru za informatiku/ www.skbm.ba
5. Pismohrani

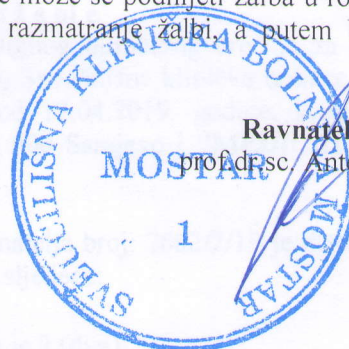

Ravnatelj SKB Mostar
prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr.med.